



6.3.2 ต้องมีการเฝ้าระวัง การตรวจสอบแจ้งเตือนและเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล



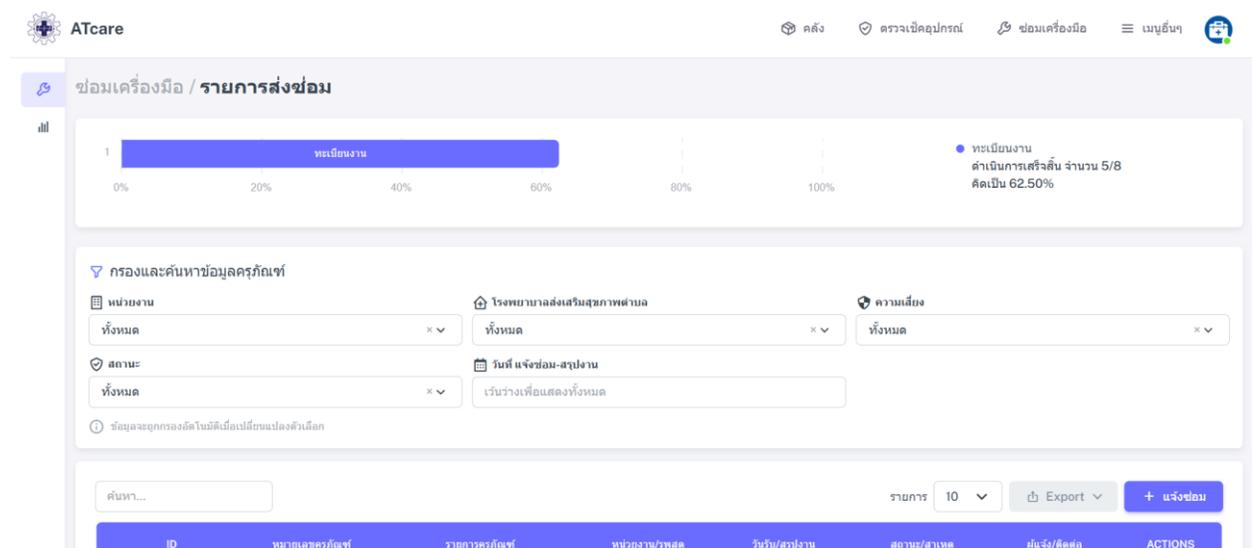

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

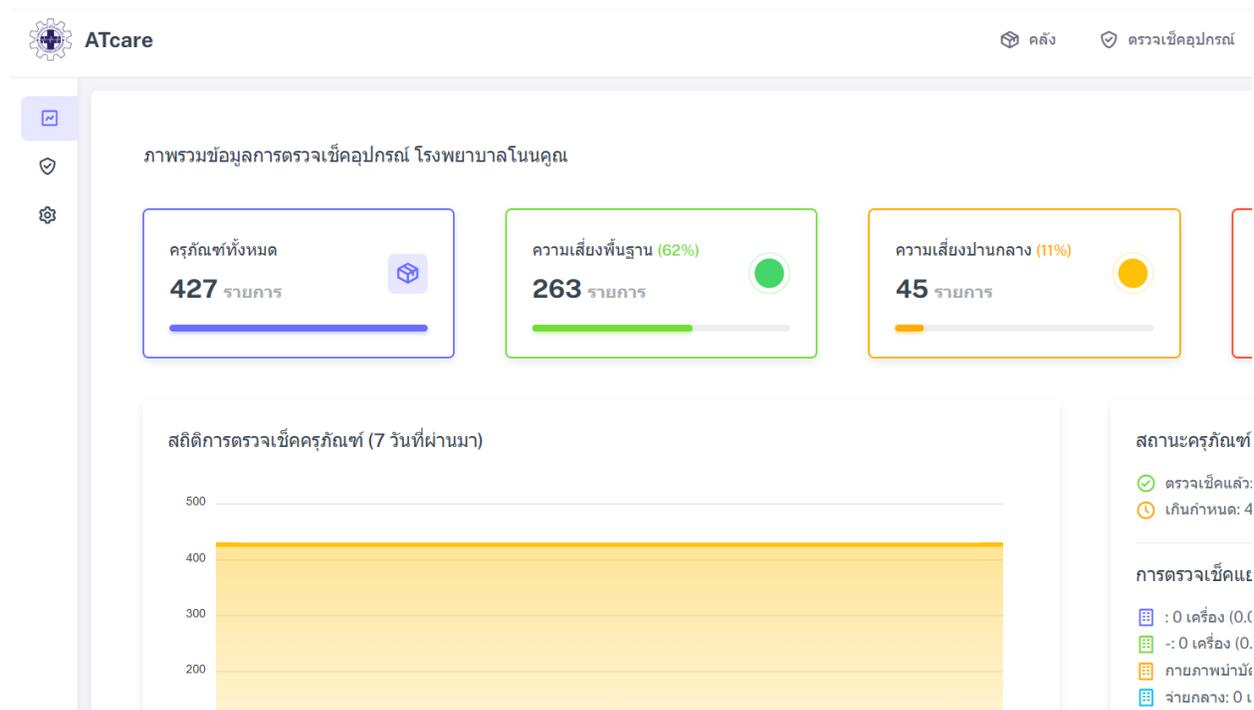

และหากมีเรื่องแจ้งจากบริษัทผู้ขายเครื่องมือแพทย์ รวมถึงเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้เก็บคืน หรือ เลิกใช้ จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่ครอบครอง เพื่อให้ยุติการใช้ เพื่อป้องกันอันตราย