

6.2.1 เครื่องมือทางการแพทย์ต้องได้รับรองมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผู้ขายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์

3.10 เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติสำหรับฝึกการใช้งาน สามารถสั่งการด้วยรีโมท

3.11 เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติสำหรับฝึกการใช้งาน

ขนาดและรูปร่างทำเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ

3.4 สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้งานแบบเสียง ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ


3.5 มี VDO สอนการใช้งานในตัวเครื่อง แยกกันระหว่างผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่

3.6 ผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ MIL-STD-810G, IEC60068-2-32, EN/IEC 60601-1, EN1789
แสดงดังนี้

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 ใช้อุปกรณ์ในการกระตุ้นหัวใจตามที่ระบุไว้ใน AHA Guideline

4.2 สามารถประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติที่ต้องการการกระตุ้นหัวใจ

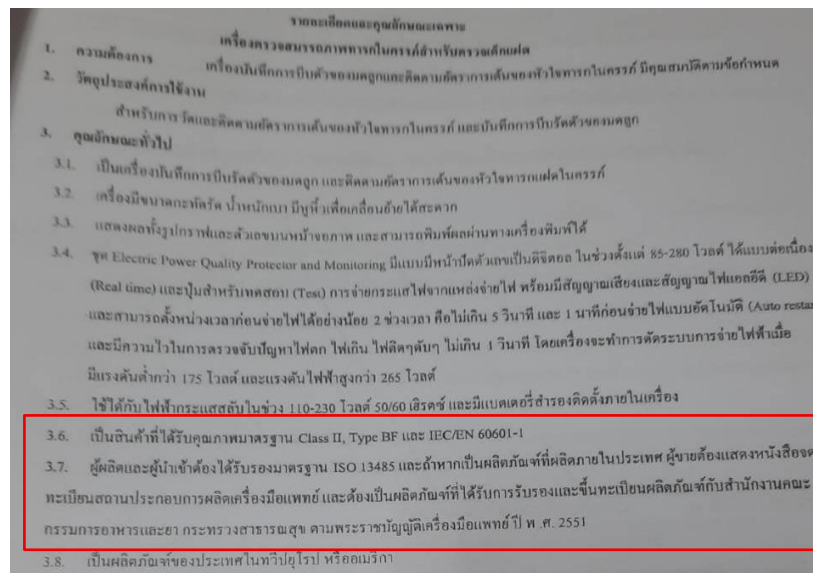

6. เงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

- 6.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งช่วงจากบริษัทผู้นำเข้า
- 6.2. ผู้นำเข้าหรือผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 เพื่อขอรับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และรองรับระบบ H ของโรงพยาบาล
- 6.3. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี