



6.3.2 ต้องมีการเฝ้าระวัง การตรวจสอบแจ้งเตือนและเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล

มีการรายงานเครื่องมือชำรุด และแจ้งส่งซ่อมผ่านทางช่องทาง LINE

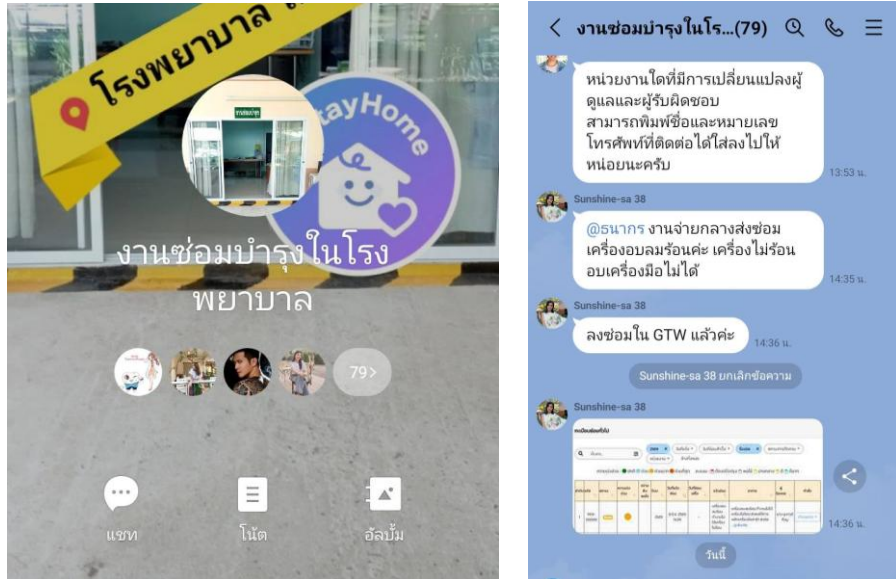

มีการรายงานเครื่องมือชำรุด และแจ้งส่งซ่อมผ่านระบบGTWBACKoffice

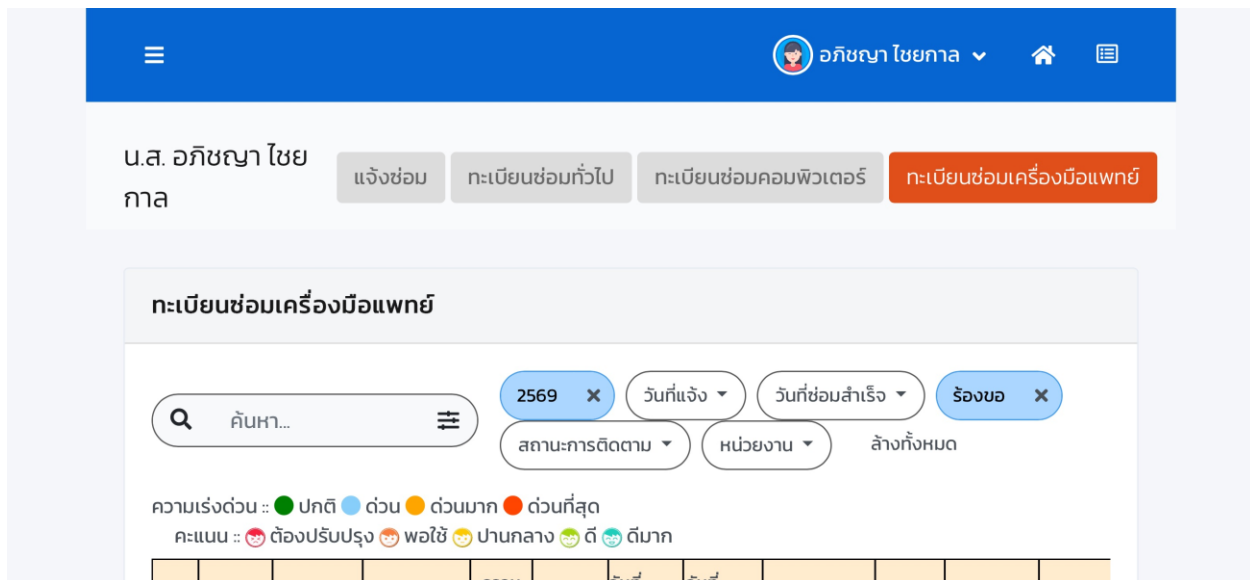

ความแรงดัน :: ● ปกติ ● ต่ำ ● ต่ำมาก ● ต่ำที่สุด
 คะแนน :: 😞 ต้องปรับปรุง 😊 พอใช้ 😊 ปานกลาง 😊 ดี 😊 ดีมาก

ลำดับ	รหัส	สถานะ	ความแรงดัน	ความพึงพอใจ	ปีงบประมาณ	วันที่แจ้งซ่อม	วันที่ซ่อมเสร็จ	แจ้งซ่อม	อาการ	ผู้ร้องขอ	คำสั
1	M69-00001	ร้องขอ	●		2569	14 พ.ค. 2569 14:51	-	BP monitor sw.นค.6515-030-0021/5	เครื่องบีบวัดความดันที่ไม่เป็นไปตามที่ตั้งค่าการวัดไว้	นาง ศดา นันท์ เนตรใส	ทำราย

แสดง 10 รายการ ทั้งหมด 1 รายการ Previous 1 Next

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์



และหากมีเรื่องแจ้งจากบริษัทผู้ขายเครื่องมือแพทย์ รวมถึงเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีโซยาให้เก็บคืน หรือ เลิกใช้ จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่ครอบครอง เพื่อให้ยุติการใช้ เพื่อป้องกันอันตราย